



## DELIBERAZIONE N. 0380 DEL 15 MAR. 2022

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Centro di Costo: A0RZ21JC1S
Codice settore proponente: BSDG 4631 del 24/02/2022.	
<b>Oggetto:</b> "Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale dedicato all'apparecchiatura per Otoemissioni Madsen Accuscreen per le necessità dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in favore di Natus Medical S.r.l." CIG Z80355BA83	
L'estensore (Dott.ssa Sabrina Mataloni)	IL DIRETTORE GENERALE Dr. Narciso Mostarda
<b>Parere del Direttore Amministrativo: D.ssa Paola Longo</b> <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma _____	Data 12.03.2022
<b>Parere del Direttore Sanitario f.f.: D.ssa Cesira Natalina Piscioneri</b> <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma _____	Data 14.03.2022
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale. Voce del conto economico/ Patrimoniale su cui si imputa l'importo: <b>Vedere "Allegato 2022-2024 Assunzione Autorizzazione"</b> Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale: Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini Firma _____ Data 09/03/2022	
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza Responsabile del Procedimento: (Dott. Paolo Farfusola) Firma _____	Data 07.03.2022
Il Dirigente: (Dott. Paolo Farfusola) Firma _____	Data 07.03.2022

## IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

### VISTI

il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421;

l'art. 26 della Legge n. 488/1999 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)";

il D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. concernente "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

il D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

la Legge Regionale Lazio del 30 dicembre 2021 n. 20 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2022";

la Legge Regionale Lazio del 30 dicembre 2021 n. 21 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024;

### PREMESSO

che, in data 02/02/2022 con nota doc. n. 16585/2022 (Allegato 1), il Direttore della U.O.C. Economato ha trasmesso alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi la richiesta di acquisto di materiale di consumo dedicato all'apparecchiatura per Otoemissioni Madsen Accuscreen in uso presso la T.I. Neonatale ed il Nido d'Osservazione per un fabbisogno biennale, indicando quale ditta fornitrice dei dispositivi sopraccitati Natus Medical S.r.l.

I codici e i quantitativi dei dispositivi d'interesse sono così ripartiti:

- n. 4750 pz tappini colore verde 4,0 mm cod. 8-68-32111;
- n. 500 pz tappini colore rosa 4,5 mm cod. 8-68-32112;
- n. 500 pz tappini colore giallo 3,7 mm cod. 8-68-32110;
- n. 8250 pz tappini colore blu 5,0 mm cod. 8-68-32113;
- n. 2 pz cavo dati cod. 8-69-41101;
- n. 20 pz PROBE TE OAE cod. 1-21-61001.

### CONSIDERATO


che presso la T.I. Neonatale ed il Nido d'Osservazione è in uso l'apparecchiatura per Otoemissioni Madsen Accuscreen come rappresentato, con doc. n. 16585/2022, dalla U.O.C. Economato;

### DATO ATTO

che la fornitura di che trattasi ha ad oggetto l'acquisizione di un bene presso un operatore economico determinato per ragioni di natura tecnica per il cui affidamento è consentito applicare l'art. 63, comma 2 lett.) b n. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita "Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: .....omissis..... b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: .... omissis.... 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici";

### ACQUISITA

l'offerta economica di Natus Medical S.r.l., del 23/02/2022 prot. 7108, allegata al presente provvedimento (Allegato 2) quale parte integrante e sostanziale, per la fornitura materiale di



consumo dedicato all'apparecchiatura per Otoemissioni Madsen Accuscreen in uso presso la T.I. Neonatale ed il Nido d'Osservazione dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

**RITENUTO**

pertanto di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) n.2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale di consumo dedicato all'apparecchiatura per Otoemissioni Madsen Accuscreen per le necessità della T.I. Neonatale ed il Nido d'Osservazione dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in favore di Natus Medical S.r.l., per un importo complessivo pari a € 13.998,32 Iva esclusa;

**TENUTO CONTO**

che stante il valore annuale della fornitura, inferiore a € 50.000,00 annui, non risulta necessario richiedere apposita autorizzazione da parte della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, così come da DCA n. U00287 del 07/07/2017;

**VERIFICATO**

che la contabilizzazione degli oneri economici derivanti dal presente atto, andrà a valere sugli esercizi e secondo l'articolazione di seguito riportata:

Conto Economico	2022/Aut. 6	2023 /Aut. 6	2024/Aut. 6	Totale Iva Inclusa
501010314000	€ 7.115,80	€ 8.538,96	€ 1.423,19	€ 17.077,95

**VISTO**

l'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che impone alle Stazioni Appaltanti, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento con i compiti previsti dal suddetto D.Lgs. 50/2016, cui si fa integrale rinvio;

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

**PROPONE**

**di affidare**, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di materiale di consumo dedicato all'apparecchiatura per Otoemissioni Madsen Accuscreen per le necessità della T.I. Neonatale ed il Nido d'Osservazione dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in favore di Natus Medical S.r.l. per un importo complessivo pari a € 13.998,32 Iva esclusa;

**di dare atto** che l'affidamento in parola, ha una durata di mesi 24 (ventiquattro);

**di nominare** quale Responsabile del procedimento per l'affidamento oggetto del presente provvedimento il Dott. Paolo Farfusola, Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal D. Lgs. 50/2016, cui si fa integrale rinvio e quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Marcello Valensise, Direttore della U.O.C. Economato;

**di contabilizzare** gli oneri economici derivanti dal presente atto a valere sugli esercizi e secondo l'articolazione di seguito riportata:

Conto Economico	2022/Aut. 6	2023 /Aut. 6	2024/Aut. 6	Totale Iva Inclusa
501010314000	€ 7.115,80	€ 8.538,96	€ 1.423,19	€ 17.077,95

**di provvedere**, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

**IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**  
(Dott. Paolo Farfusola)

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di Delibera, "Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale dedicato all'apparecchiatura per Otoemissioni Madsen Accuscreen per le necessità dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in favore di Natus Medical S.r.l." CIG Z80355B.A83, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

**di affidare**, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di materiale di consumo dedicato all'apparecchiatura per Otoemissioni Madsen Accuscreen per le necessità della T.I. Neonatale ed il Nido d'Osservazione dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in favore di Natus Medical S.r.l. per un importo complessivo pari a € 13.998,32 Iva esclusa;

**di dare atto** che l'affidamento in parola, ha una durata di mesi 24 (ventiquattro);

**di nominare** quale Responsabile del procedimento per l'affidamento oggetto del presente provvedimento il Dott. Paolo Farfusola, Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal D. Lgs. 50/2016, cui si fa integrale rinvio e quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Marcello Valensise, Direttore della U.O.C. Economato;

**di contabilizzare** gli oneri economici derivanti dal presente atto a valere sugli esercizi e secondo l'articolazione di seguito riportata:

Conto Economico	2022/Aut. 6	2023 /Aut. 6	2024/Aut. 6	Totale Iva Inclusa
501010314000	€ 7.115,80	€ 8.538,96	€ 1.423,19	€ 17.077,95

**di provvedere**, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 13 pagine di cui n. 8 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto sarà affisso all'Albo Aziendale nel sito internet Aziendale [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it) per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dr. Narciso Mostarda)




**AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI**

 U.O.C. *Economato, Gestione Contratti e Logistica*
**Documento N. 16585/2022**

 Roma, li 02/02/2022

 Al Direttore U.O.C.  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Dott. Paolo Farfusola

Oggetto: fabbisogno biennale di materiale dedicato all'apparecchiatura per Otoemissioni Madsen  
 Accuscreen – RETTIFICA.

A rettifica della ns. nota prot.13018 del 26/01/2022, si invia il nuovo fabbisogno per il biennio 2022-2023, del materiale di consumo dedicato all'apparecchiatura per Otoemissioni Madsen Accuscreen in uso presso la T.I. Neonatale ed il Nido d'Osservazione (distributore: Ditta Natus Medical S.r.l.):

tappini colore verde 4,0 mm - cod.8-68-32111 - 4.750 pezzi  
 tappini colore rosa 4,5 mm - cod.8-68-32112 - 500 pezzi  
 tappini colore giallo 3,7 mm - cod.8-68-32110 - 500 pezzi  
 tappini colore blu 5,0 mm - cod.8-68-32113 - 8.250 pezzi  
 cavo dati - cod.8-69-41101 - 2 pezzi  
**PROBE TE OAE - cod.1-21-61001 - 20 pezzi**

Si rappresenta che l'importo presunto della fornitura è di Euro 14.000,00 + IVA e che ai fini della contabilizzazione della spesa lo stesso dovrà essere imputato sul conto 501010314000 - autorizzazione n.6 - anni 2022 - 2023.

Considerate le numerose difficoltà che si riscontrano sui tempi di evasione delle forniture, si chiede, inoltre, che sia specificato quanto segue:

**LE CONSEGNE DEVONO ESSERE EFFETTUATE TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELL'ORDINE.**

Si ricorda, infine, che per la corretta individuazione e gestione dei prodotti nell'anagrafica Areas Master è obbligatorio che nell'offerta siano indicati CND e Numero Repertorio dei dispositivi oggetto della fornitura.

Cordiali saluti

 IL DIRETTORE  
 Dott. Marcello *Valsensise*


Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

 e-mail: [economato@scf.gov.it](mailto:economato@scf.gov.it) - Ufficio Gestione Beni Economici tel.0658706232 - fax: 06 58706503

5

# natus.

Montegrotto Terme, 10/02/2022

**San Camillo Forlanini**  
**Prot. Ingresso N. 0007108/2022**  
**Del 23/02/2022**



Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO  
FORLANINI**  
**UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**OGGETTO: VS PROT. 4969/2022 DEL 09/02/2022**

Il sottoscritto SCHWENDLER UWE, nato a Bremerhaven (DE) il 24/11/1966, - C.F. SCHWUE66S24Z112S legale rappresentante della ditta NATUS MEDICAL SRL, con la qualifica di PROCURATORE SPECIALE SEDE LEGALE e OPERATIVA in MONTEGROTTO TERME (PD), via del Commercio 27 - P.IVA E C.F. 05025030288  
Iscritta Registro Imprese presso la CCIAA di PADOVA n. iscr. 05025030288  
P.E.C. [natusmedicalsr@legalmail.it](mailto:natusmedicalsr@legalmail.it) E-MAIL [commercialeitalia@natus.com](mailto:commercialeitalia@natus.com) TEL. 049 8911110

Ringraziandovi per l'invito, di seguito propone la propria offerta economica:

CODICE PROD	PRODOTTO	Q.TA'	PREZZO LISTINO €	SCONTO	PREZZO OFFERTO UNITARIO €.	TOTALE OFFERTA €.
8-68-32111	Tappini 4.0 mm verde pastello (Cf. 250 pz.)	19	223,00	11,00%	0,80	3.770,93
8-68-32112	Tappini 4,5 mm rosa pastello (Cf. 250 pz.)	2	223,00	11,00%	0,80	396,94
8-68-32110	Tappini 3,7 mm giallo pastello (Cf. 250 pz.)	2	223,00	11,00%	0,80	396,94
8-68-32113	Tappini 5.0 mm blu pastello (Cf. 250 pz.)	33	223,00	11,00%	0,80	6.549,51
8-69-41101	Sonda per TEOAE	2	1.667,00	19,62%	1.340,00	2.680,00
1-12-61001	Sonda Tip (10 pz.)	2	120,00	15,00%	10,20	204,00
<b>Totale</b>						<b>13.998,32</b>

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

**RESA:** Franco destino Vs Magazzino

**CONSEGNA:** 5/7 gg solari

**I.V.A.:** 22% a norma di legge a carico dell'acquirente, non incluso nei prezzi sopra indicati

**PAGAMENTO:** RD 60gg

**VALIDITA' OFFERTA:**

In fede

**NATUS MEDICAL SRL**  
**Schwendler Uwe**  
**Procuratore Speciale**

**NATUS MEDICAL SRL**

Via del Commercio, 27  
35036 MONTEGROTTO TERME (PD)  
Cod. Fisc. e Partita IVA 05025030288

Natus Medical srl | Via Del Commercio, 27 - 35036 Montegrotto Terme (PD), Italy | P.I. 05025030288 | [natus.com](http://natus.com)


Tel. 049/8911.110 Fax, 049/8911.316 E-mail: [infoitalia@natus.com](mailto:infoitalia@natus.com) PEC: [natusmedicalsr@legalmail.it](mailto:natusmedicalsr@legalmail.it)

Azienda con sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485

6

natus.

## SCHEDA TECNICA PROBE TIP 1-12-61001



- Descrizione:** PROBE TIP – tappino sonda per Accuscreen  
**Confezionamento:** da 10 pezzi  
**Utilizzo:** tappini auricolari per lo screening uditivo su neonati da utilizzare su sonda per otoemissioni acustiche

### Modo di utilizzo:

#### Sostituzione del tappino sonda



Per rimuovere il tappino sonda dalla sonda MADSEN AccuScreen, tenere il corpo della sonda tra il pollice e l'indice.



Tenere il tappino sonda con il pollice e l'indice come illustrato in figura e tirare separando il tappino dal corpo della sonda. Non impiegare forza eccessiva.



È anche possibile posare la punta del tappino sonda sul pollice, porre l'indice sulla parte superiore del tappino e sollevarlo dal corpo della sonda nella direzione indicata dalla freccia. Non impiegare forza eccessiva.

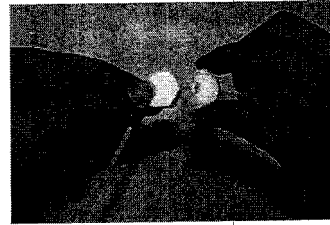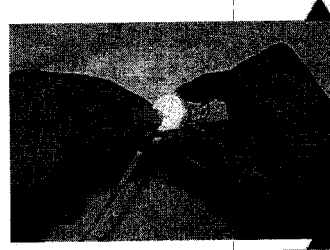

#### Pulizia della sonda

Usare un panno inumidito con alcool per pulire il cavo della sonda e la superficie del corpo della sonda. Usare solo disinfettanti su salviette e accertarsi che il liquido non entri nel corpo della sonda.

#### Importante:

per la pulizia periodica del corpo della sonda, contattare il proprio reparto di assistenza autorizzato.

#### Attenzione:

il corpo della sonda contiene componenti sensibili. Non pulire mai i diaframmi acustici nel corpo della sonda, né meccanicamente né con liquidi. Ciò potrebbe arrecare danni alla sonda.

#### Attenzione:

anche una minima quantità di umidità può disciogliere il cerume residuo e contaminare le parti sensibili nel corpo della sonda.

#### Pulizia del tappino sonda

I tappini sonda sono pluriuso e possono essere puliti.

#### Attenzione:

Natus Medical srl | Via Del Commercio, 27 – 35036 Montegrotto Terme (PD), Italy | P.I. 05025030288 | [natus.com](http://natus.com)

Tel. 049/8911.110 Fax. 049/8911.316 E-mail: [infoitalia@natus.com](mailto:infoitalia@natus.com) PEC: [natusmedicalsrl@legalmail.it](mailto:natusmedicalsrl@legalmail.it)

Azienda con sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485

7

# natus.

i tappini sonda devono essere smaltiti secondo le norme locali. Osservare sempre la conformità agli standard locali di igiene. Il tappino sonda normalmente non viene a contatto con la cute o con le secrezioni del condotto uditivo, in quanto è coperto dall'auricolare, tuttavia è necessario controllare i canali nel tappino sonda ogni volta che si usa la sonda. Quantità anche piccole di cerume o vernice caseosa possono bloccare i canali della sonda o essere depositate sul tappino sonda

**Nota:**

rimuovere il tappino dalla sonda. Usare il filo di pulizia per pulire i canali acustici nel tappino sonda. Eseguire la pulizia sempre dall'estremità posteriore del tappino sonda. Accertarsi di aver rimosso ogni residuo dal filo di pulizia con un disinfettante prima di estrarlo attraverso i canali della sonda. Il tappino sonda deve essere completamente asciutto prima di essere posto sul corpo della sonda.

**Latex: FREE**

**NON STERILE**

**PLURIUSO**


**Dispositivo Medico CE**

**CND: Z12149085**


**RDM: 527088**

**Produttore: NATUS MEDICAL DENMARK A/S**

**ULTERIORI INFO SULL'APPLICAZIONE DEL TAPPINO SULLA SONDA:**

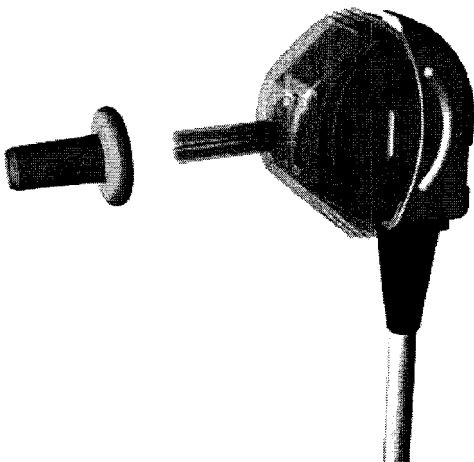

Il nuovo tappino sonda è progettato in modo che il tappino stesso e l'auricolare creino i canali acustici, distinguendosi quindi dal precedente in cui i canali acustici erano all'interno del tappino sonda.

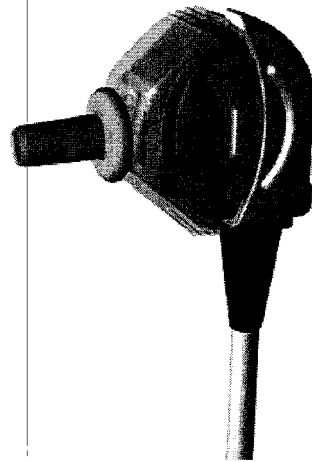

Il tappino sonda è leggermente più lungo del modello precedente, quindi chi era solito impiegare tale versione di MADSEN AccuScreen potrebbe dover selezionare una misura di auricolare diversa da quella abituale.

Natus Medical srl | Via Del Commercio , 27 – 35036 Montegrotto Terme (PD), Italy | P.I. 05025030288 | [natus.com](http://natus.com)

Tel. 049/8911.110 Fax: 049/8911.316 E-mail: [infoitalia@natus.com](mailto:infoitalia@natus.com) PEC: [natusmedicalsrl@legalmail.it](mailto:natusmedicalsrl@legalmail.it)


Azienda con sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485

8



natus.

## SCHEDA TECNICA EARTIPS ACCUSCREEN

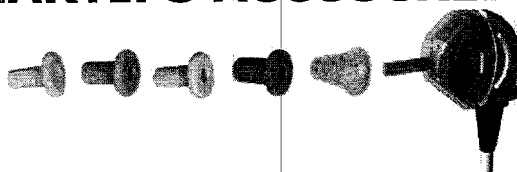

Auricolare	Misura	CODICE PRODOTTO 50/sacchetto	CODICE PRODOTTO 250/sacchetto
Giallo pastello	3,7 mm	8-68-32100	8-68-32110
Verde pastello	4,0 mm	8-68-32101	8-68-32111
Rosa pastello	4,5 mm	8-68-32102	8-68-32112
Azzurro pastello	5,0 mm	8-68-32103	8-68-32113
Trasparente a cono	4 - 7 mm	8-68-32104	8-68-32114
In schiuma:	6 - 10 mm	8-68-32105	-

**Descrizione:** tappini auricolari in gomma o schiuma, di varie misure e colori per lo screening uditivo su neonati da utilizzare su sonda per otoemissioni acustiche

**Misure** varie misure (vedi tabella sopra)

**Confezionamento:** da 50 pezzi o da 250 pezzi

**Utilizzo:** tappini auricolari per lo screening uditivo su neonati da utilizzare su sonda per otoemissioni acustiche

**Modo di utilizzo:** Selezionare un auricolare adatto per il condotto uditivo del paziente. Potrebbe essere necessario provare diverse dimensioni per trovare quella adeguata. Premere delicatamente l'auricolare sul tappino sonda finché non poggia saldamente sulla base della sonda. È molto più semplice inserire e rimuovere l'auricolare se si applica una delicata torsione. Per questa operazione, accertarsi di reggere il corpo della sonda e non il cavo. È importante che il tappino sonda sia orientato nella direzione della membrana timpanica e non verso la parete del condotto uditivo

**Latex: FREE**

**NON STERILE**

**MONOUSO NON LAVABILE**

**Dispositivo Medico CE**

**CND: Z12149085**

**RDM: 519803**

**Produttore: NATUS MEDICAL DENMARK A/S**

Natus Medical srl | Via Del Commercio, 27 - 35036 Montegrotto Terme (PD), Italy | P.I. 05025030288 | [natus.com](http://natus.com)


Tel. 049/8911.110 Fax. 049/8911.316 E-mail: [infoitalia@natus.com](mailto:infoitalia@natus.com) PEC: [natusmedicalsrl@legalmail.it](mailto:natusmedicalsrl@legalmail.it)

Azienda con sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485


9

# natus.

## ULTERIORI INFO SULL'APPLICAZIONE DEL TAPPINO SULLA SONDA:

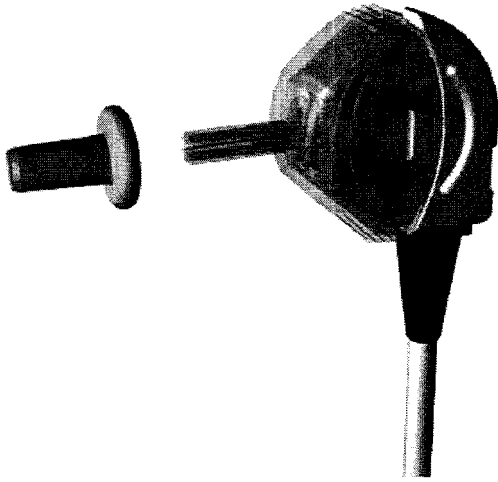

Il nuovo tappino sonda è progettato in modo che il tappino stesso e l'auricolare creino i canali acustici, distinguendosi quindi dal precedente in cui i canali acustici erano all'interno del tappino sonda.

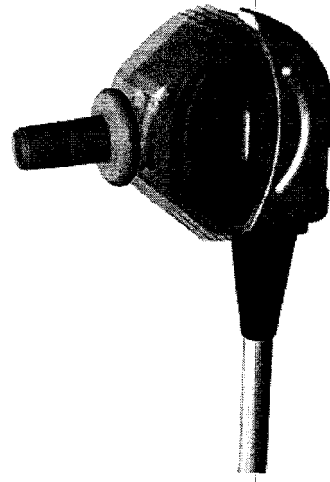

Il tappino sonda è leggermente più lungo del modello precedente, quindi chi era solito impiegare tale versione di MADSEN AccuScreen potrebbe dover selezionare una misura di auricolare diversa da quella abituale.

**SONDA ACCUSCREEN**

**Probe data**

Print date:

Serial number: XXXXX

PROM ID: XXXX

Probe version: EP-TE

Calibration date: 20XX

Spk 1kHz ch1: 0 dB ch2: 0 dB mic: 1 dB

Spk 2kHz ch1: 0 dB ch2: 0 dB

Spk 4kHz ch1: 0 dB ch2: 0 dB

Spk 6kHz ch1: 2 dB ch2: 0 dB

**Versioni della Sonda**

Ci sono due tipi di sonde per il sistema AccuScreen:

- TEOAE/ABR probe
- TEOAE/DPOAE/ABR probe

La sonda TEOAE/ABR, che può essere usata con tutti i sistemi di misurazione TEOAE e ABR, è identificata da una striscia grigia in rilievo dove il cavo si collega alla testa della sonda




La sonda TEOAE / DPOAE / ABR che può essere usata per TUTTI i test. Essa ha una striscia blue in rilievo sulla testa della sonda. Entrambe le sonde sono consegnate con un puntale sonda intercambiabile, sul quale deve essere applicato il tappino monouso



○ Hearing Assessment ○ Fitting Systems ○ Balance Assessment

GN Otometrics, Denmark. +45 45 75 55 55. info@gnotometrics.dk  
www.otometrics.com

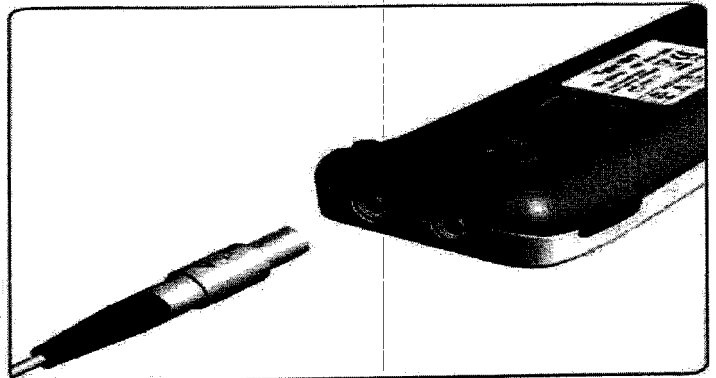

Entrambi i tipi di sonda sono inseriti nella presa contrassegnata da un semicerchio blu sullo strumento Accuscreen

**ATTENZIONE**

**Non inserire mai la sonda nel condotto auricolare senza l'uso del tappino auricolare nuovo**

**CODICI PER IL RIORDINO**

- Sonda TEOAE/ABR 8-69-41101
- Sonda TEOAE/DPOAE/ABR 8-69-41100
- Puntali Sonda 1-21-61001
- Tappini auricolari
- 3,7mm Pastel yellow (50 pcs.) 8-68-32100
- 4,0mm Pastel green (50 pcs.) 8-68-32110
- 4,5mm Pastel pink (50 pcs.) 8-68-32111
- 5,0mm Pastel blue (50 pcs.) 8-68-32102
- 5,0mm Pastel blue (50 pcs.) 8-68-32112
- 5,0mm Pastel blue (50 pcs.) 8-68-32103
- 5,0mm Pastel blue (50 pcs.) 8-68-32113
- 4-7mm Tree, transparent (50 pcs.) 8-68-32104
- 4-7mm Tree, transparent (50 pcs.) 8-68-32114
- 6-10mm Yellow foam (50 pcs.) 8-68-32105
- Ear tip kit 8-69-41300

PATH medical GmbH  
Landsberger Strasse 65  
82110 Germering  
Germany

CE  
0124



**otometrics**  
MADSEN · AURICAL · ICS

11



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE  
LAZIO

## U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

### ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta

di Deliberazione : **BSDG 4631 / 2022**

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2022	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
6	177		501010314000			7.115,80	
<b>TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € :</b>						<b>7.115,80</b>	

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
<b>501010314000</b>	<b>MATERIALE SANITARIO NON STERILE</b>

Data 08/03/2022

Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini** .....

(Firma)

12